



No. 11-109136- -00004-0000

Fecha: 2012-02-16 16:36:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eva: 1 REGDEPOSITO
Act. 587 SOLTUDCORREC Folios: 3

Medellín, 15 de Febrero 2012

Doctor
Jose Luis Salazar Lopez
Director de Nuevas Creaciones
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá D.C.


Referencia:

Solicitud de Corrección Error Material
Patente Modelo de Utilidad
"MEDIDOR DE ALCOHOLEMIA
TELECOMUNICADO O CONTROLADO DE
FORMA REMOTA DESDE UN CENTRO DE
CONTROL O SERVIDOR"
Expediente No 11-109136

ANDRÉS MÁRQUEZ ACOSTA, actuando como apoderado del expediente citado en la referencia, de la manera más cordial me permito solicitar la corrección de la solicitud de Patente "**MEDIDOR DE ALCOHOLEMIA TELECOMUNICADO O CONTROLADO DE FORMA REMOTA DESDE UN CENTRO DE CONTROL O SERVIDOR**" en relación a:

1. El apellido del Solicitante es cual es **BANOY**, y en la Superintendencia se encuentra registrado como BALOY.
2. El tipo de Patente, ya que esta Patente fue amablemente solicitada como una **Patente Modelo de Utilidad** y en la Superintendencia se encuentra registrada como una Patente de Invención.

Atentamente,

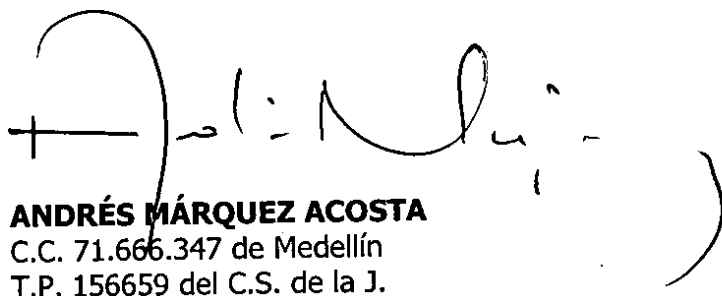
ANDRÉS MÁRQUEZ ACOSTA
C.C. 71.666.347 de Medellín
T.P. 156659 del C.S. de la J.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-SISTEMA DE NUEVAS CREACIONES
NUEVAS CREACIONES

Miercoles 15 de Febrero de 2012 - 17:33:01

Ver Anualidades	Ver Afectaciones	Ver Actuaciones	Consulta Actos Administrativos
Cerrar Ventana			

Datos de PATENTES DE INVENCIÓN

Expediente 11 109136 **Fecha de solicitud** de 2011-08-26 10:48:25

Sector INGENIERIA ELECTRICA **Clasificación** G1N 9/0 AC; Ipc

Título MEDIDOR DE ALCOHOLEMIA TELECOMUNICADO

Solicitante (s) HECTOR Y. RODRIGUEZ BALOY

Inventor (es) HECTOR Y. RODRIGUEZ BALOY

Gaceta Numero Fecha NP
636 20/01/2012 217

Estado PUBLICACION 2012-01-20 00:00:00
Etapas del Trámite

Resumen

La presente invención se relaciona con un medidor de alcoholemia, el cual cuenta con un sistema de comunicación remota con el fin de enviar la información recolectada a un servidor o centro de control, donde dicho sistema de comunicación es de doble vía toda vez que permite controlar y enviar información desde el centro de control o servidor hacia el dispositivo con el fin de solicitar en un momento específico que se deba realizar una medida para medir los niveles de alcohol en la sangre del conductor del vehículo donde se encuentre instalado. El medidor de la presente invención se compone de un sistema de alimentación que permite la entrada de voltajes externos entre 12 y 50 V DC, un microcontrolador, un sensor electroquímico, un sensor de presión diferencial, un dispositivo de visualización LCD, un timbre o sirena y un LED indicador de actividad.

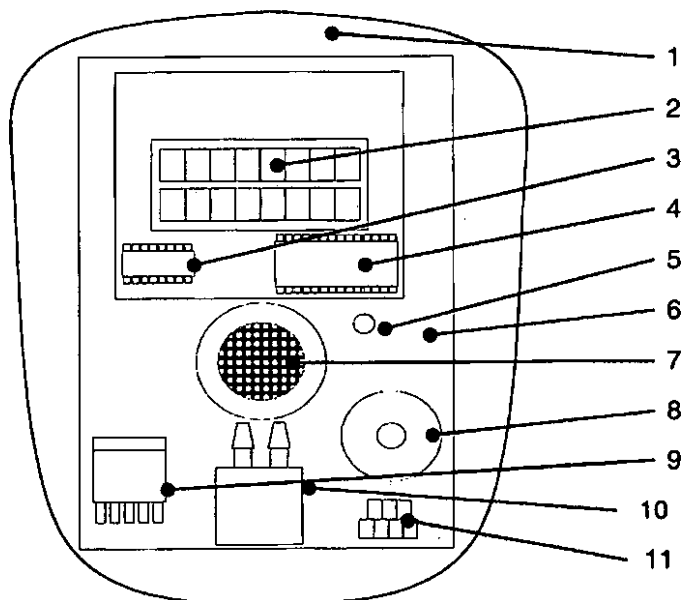


Figura 1

REGISTRO INICIAL

Expediente 11 109136 **Secu** even.0 **Fecha de solicitud** de 2011-08-26 10:48:25

Solicitante(s) HECTOR Y. RODRIGUEZ BALOY
Apoderado ANDRES MARQUEZ ACOSTA
Inventor(es) HECTOR Y. RODRIGUEZ BALOY
Actos OFICIO 14845 de 21/09/2011
Administrativos
Estado PUBLICACION 2012-01-20 00:00:00

Ver Anualidades	Ver Afectaciones	Ver Actuaciones	Consulta Actos Administrativos	Cerrar Ventana
-----------------	------------------	-----------------	--------------------------------	----------------