Fig. 8

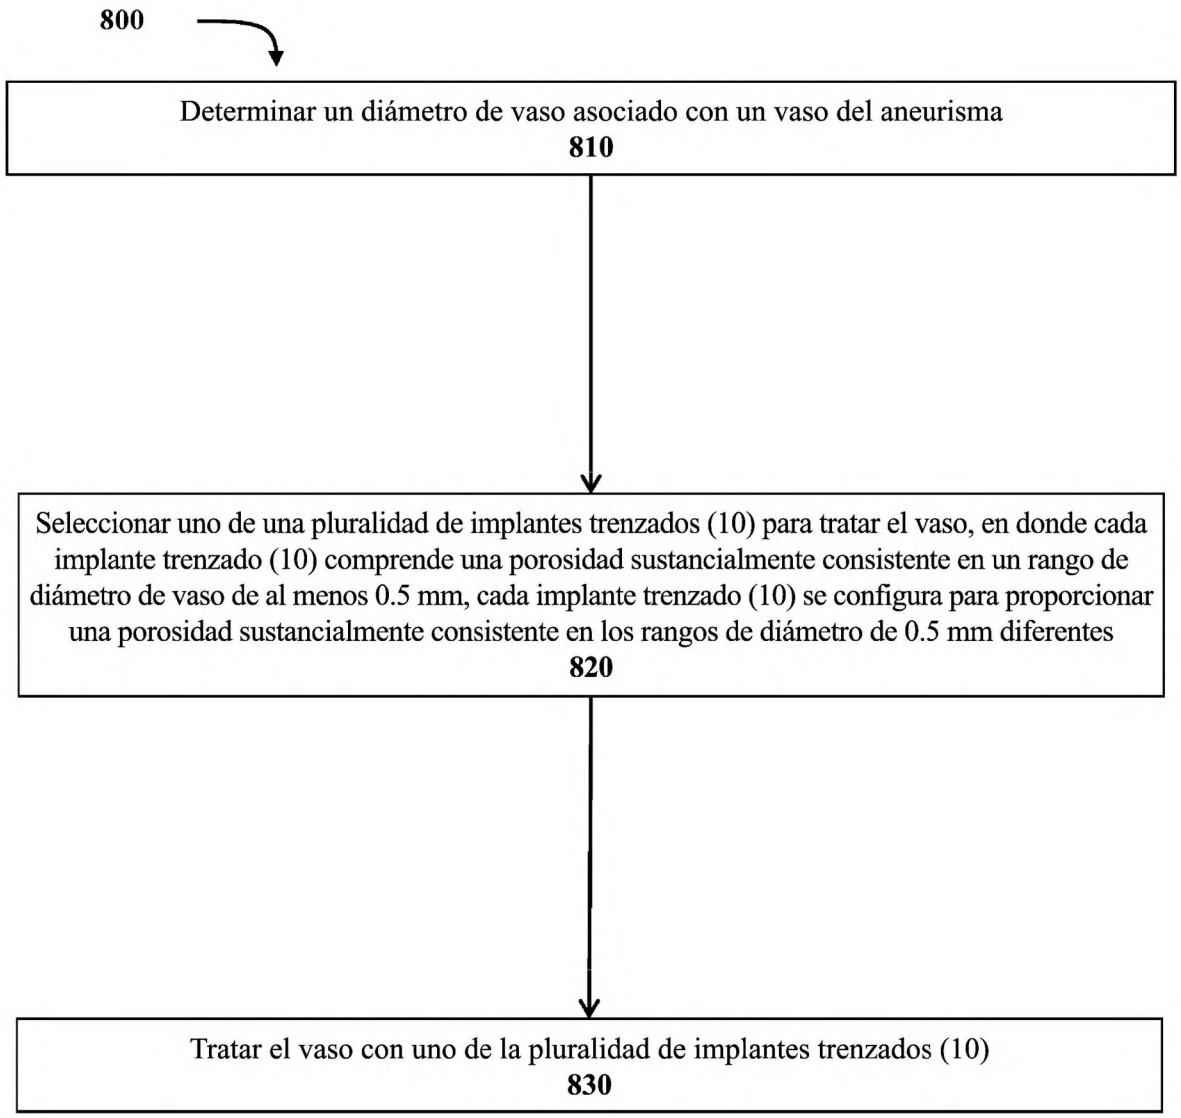
800
Determinar un diámetro de vaso asociado con un vaso del aneurisma
810
Seleccionar uno de una pluralidad de implantes trenzados (10) para tratar el vaso, en donde cada implante trenzado (10) comprende una porosidad sustancialmente consistente en un rango de diámetro de vaso de al menos 0.5 mm, cada implante trenzado (10) se configura para proporcionar una porosidad sustancialmente consistente en los rangos de diámetro de 0.5 mm diferentes
820
Tratar el vaso con uno de la pluralidad de implantes trenzados (10)
830