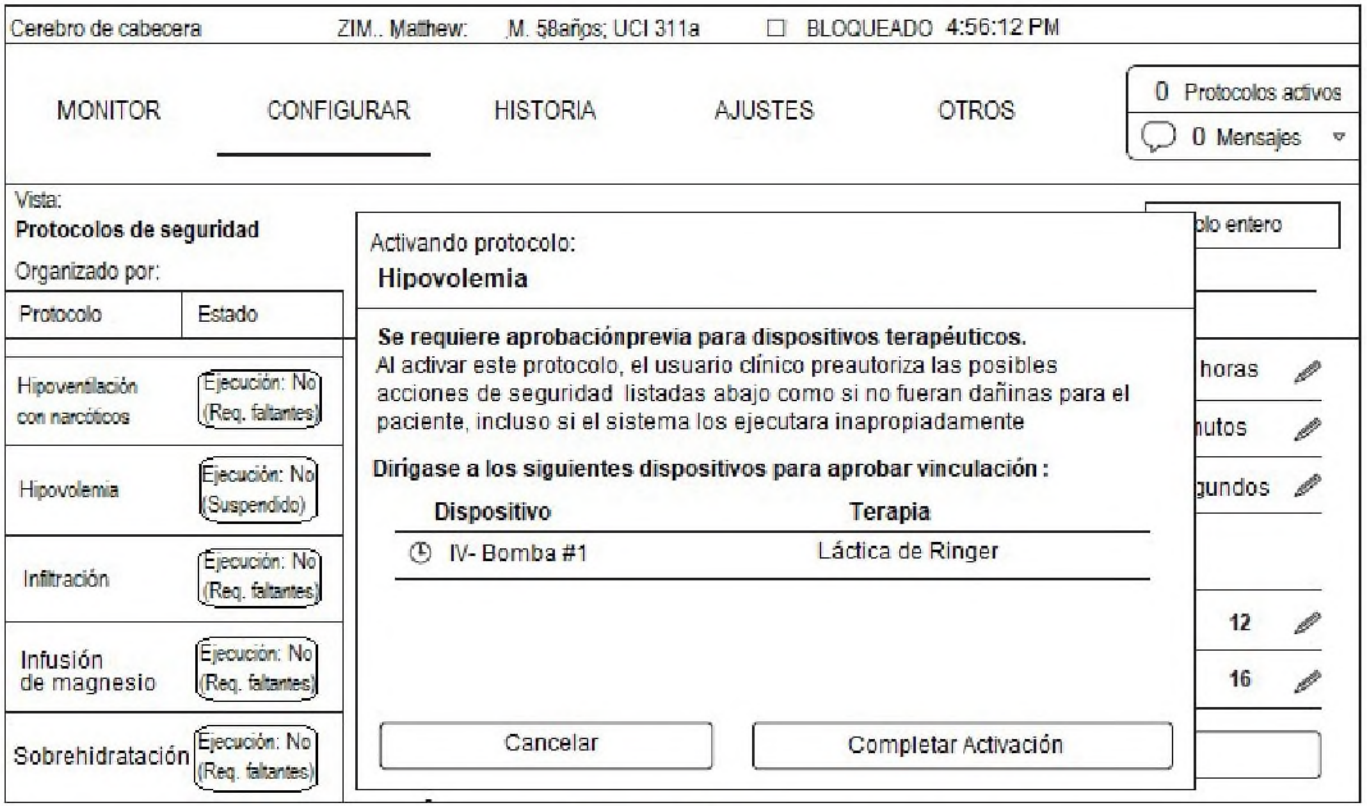
Cerebro de cabecera
ZIM.. Matthew: M. 58años; UCI 311a
BLOQUEADO 4:56:12 PM
MONITOR
CONFIGURAR
HISTORIA
AJUSTES
OTROS
0 Protocolos activos
0 Mensajes
Vista:
Protocolos de seguridad
Organizado por:
Protocolo
Estado
Hipoventilación con narcóticos
Ejecución: No (Req. faltantes)
Hipovolemia
Ejecución: No (Suspendido)
Infiltración
Ejecución: No (Req. faltantes)
Infusión de magnesio
Ejecución: No (Req. faltantes)
Sobrehidratación
Ejecución: No (Req. faltantes)
Activando protocolo:
Hipovolemia
Se requiere aprobaciónprevia para dispositivos terapéuticos.
Al activar este protocolo, el usuario clínico preautoriza las posibles acciones de seguridad listadas abajo como si no fueran dañinas para el paciente, incluso si el sistema los ejecutara inapropiadamente
Diríjase a los siguientes dispositivos para aprobar vinculación :
Dispositivo
Terapia
IV- Bomba #1
Láctica de Ringer
Cancelar
Completar Activación
horas
nutos
gundos
12
16

FIG. 15