







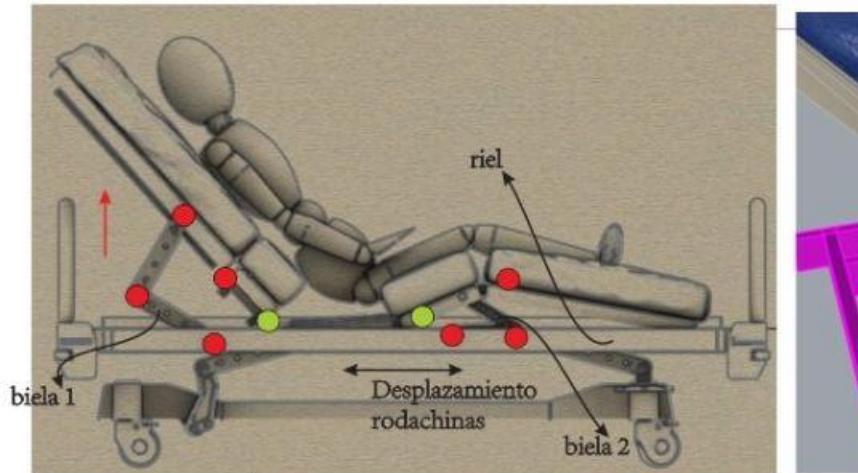

- identificación de los ejes de las bielas
ubicación de las bielas
- rieles y rodachinas para desplazamiento horizontal
diseño estructura para que la estructura no pegue con el pato
diseño en forma de riel para pato
después de identificado los movimientos se instalan las manivelas

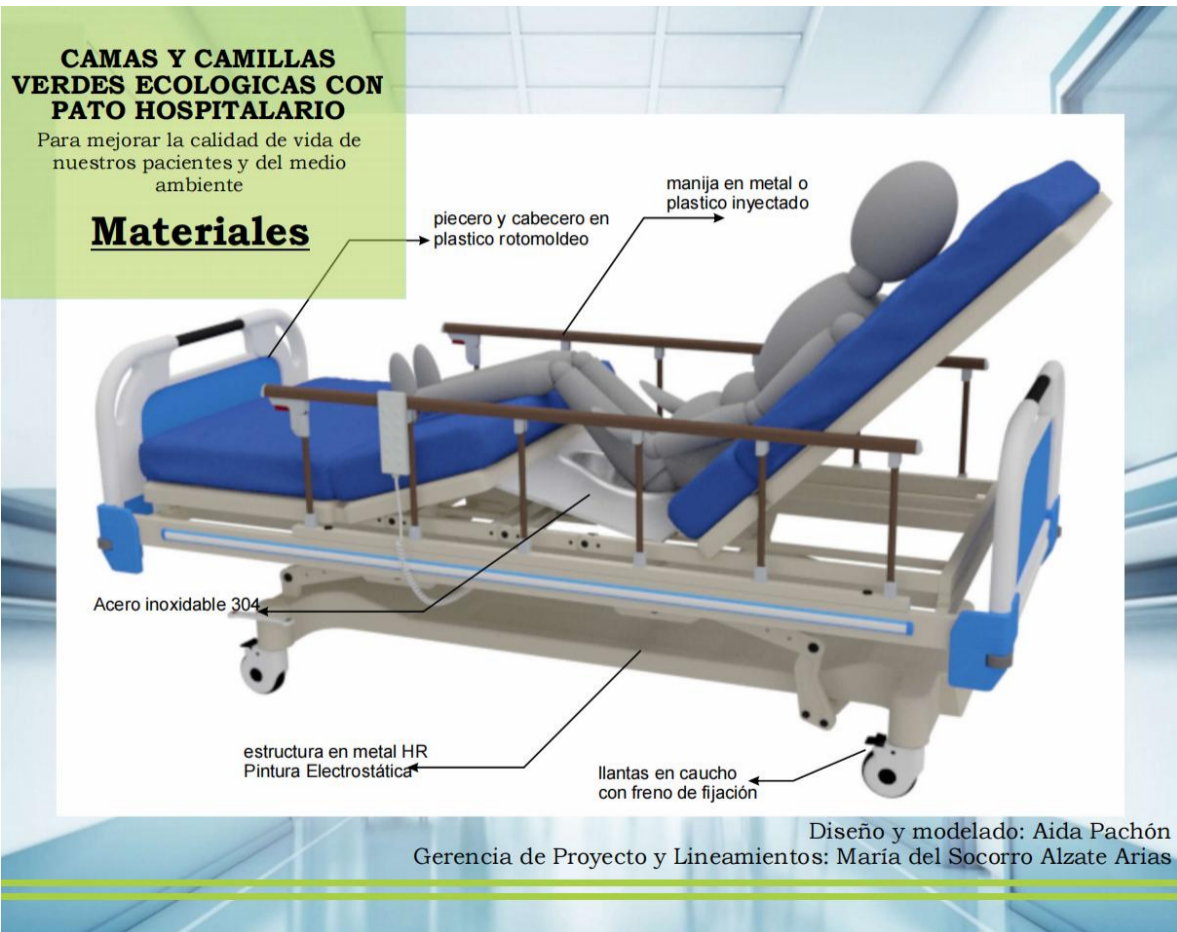

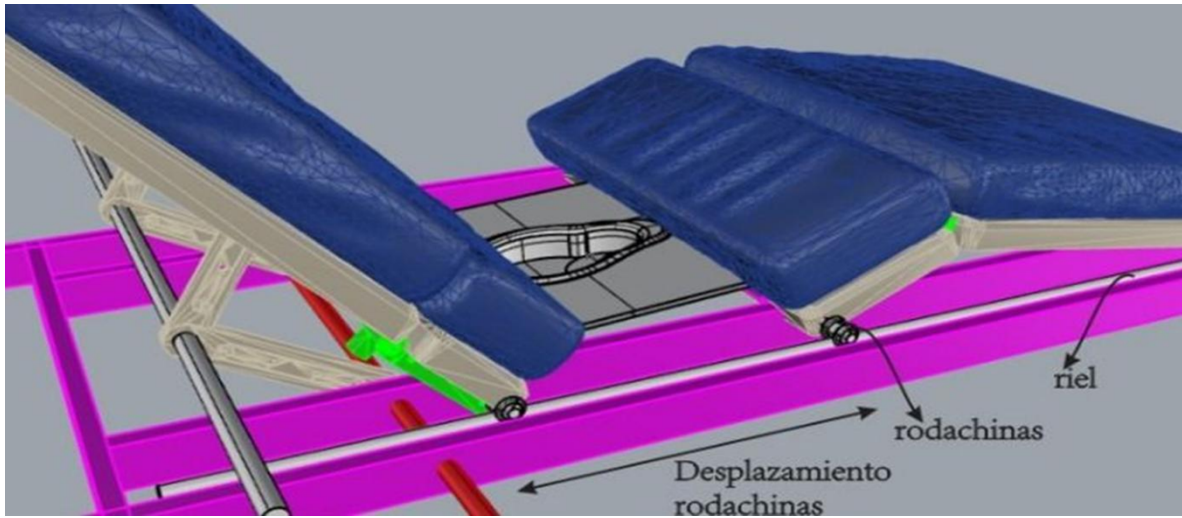

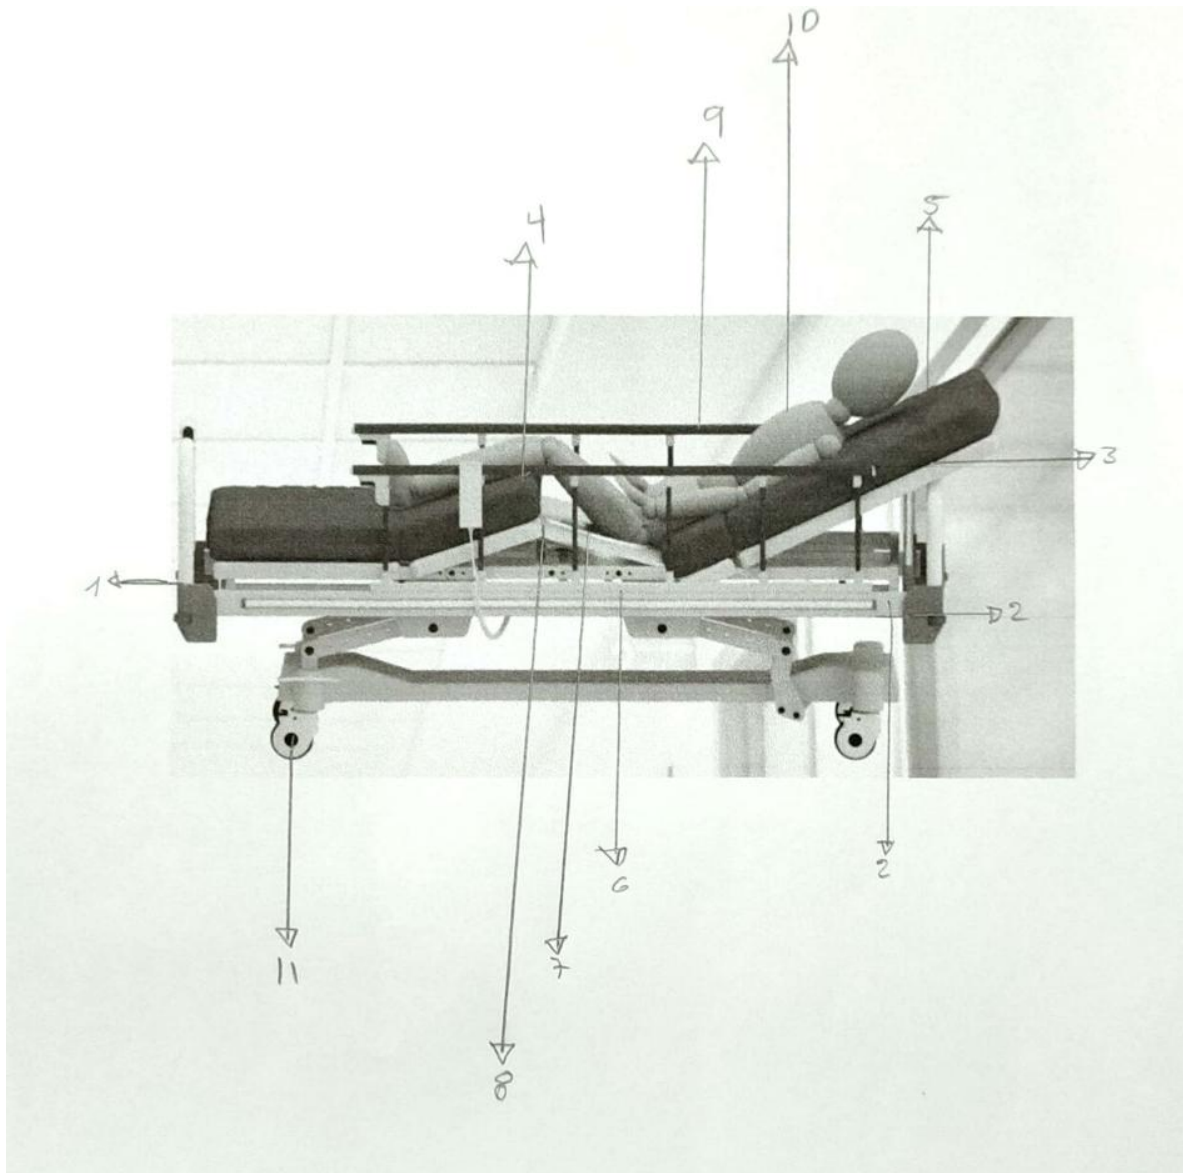


estructura secuencia

vista lateral


①




②

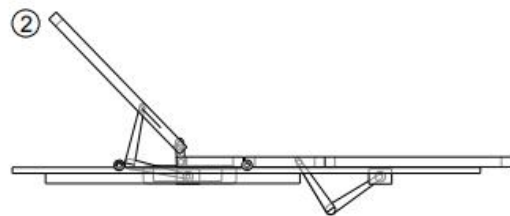


③

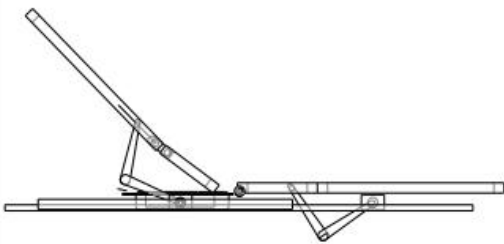

④

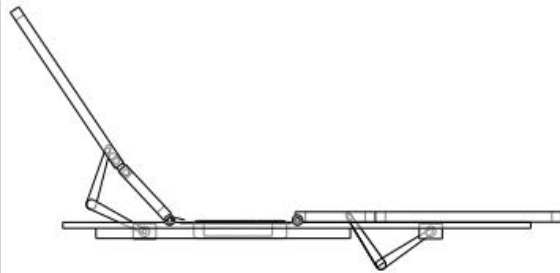

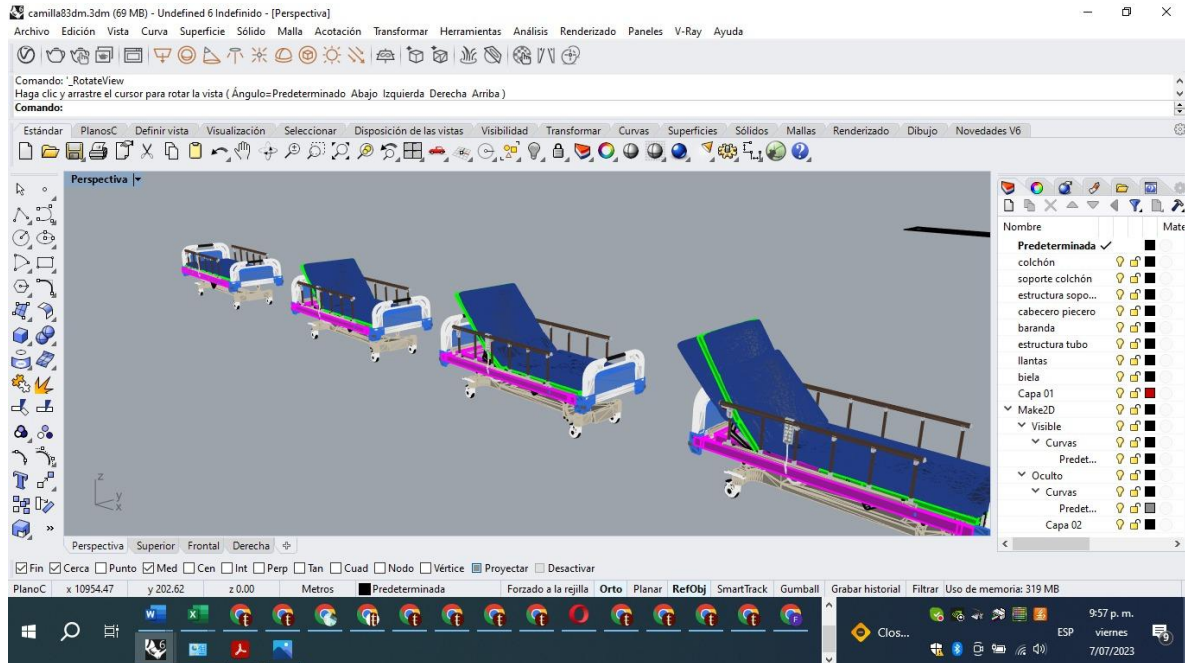

Proceso de Diseño Camillas		
Trabajo de investigación	Estándares y parámetros	
mecanismos	estructura	
	materiales reglamentarios	
	Mecanismo manual de Manivela	
modelado en 3d	modelado general	
	despiece general	
	Planos generales técnicos de la Cama	
	Planos enumeración de las partes relevantes	explicación de cada elemento
	Modelado y Planos de paso a paso del desplazamiento de las piezas	
reinención	adaptación portapato	
	remoción pato	
	funcionamiento	
Tiempo estimado	10 días	
Valor	500.000	



5 Coloca la bacinica bajo las nalgas del paciente. Desliza la bacinica bajo las nalgas del paciente con el borde curvo dirigido hacia su espalda.^[8]

- Si el paciente puede levantar sus caderas:
 - Desliza la bacinica bajo sus nalgas e indícale que descienda lentamente, usando tu mano de apoyo para guiarlo.
- Si el paciente no puede levantar sus caderas:
 - Desliza la bacinica directamente al lado de las nalgas del paciente. Mantén el lado con la apertura apuntando hacia los pies del paciente.

Y el pañal desechable para adulto. Es lo de actualidad en estos momentos en cuanto a la tecnología de la higiene y salud publica privada

Esta es la nueva innovación de la tecnología de la higiene y salud publica y privada

