

TETFLUPYROLIMET FORMA I – TGA

Método: Ramp RT → 300°C@5°C/min

Fecha de ejecución: 07-Jul-2021 11:59

Comentario: 300°C-iso5min Purga N2=90ml/min Blanco corregido

Instrumento: TGA Q500 V20.13 Construir 39

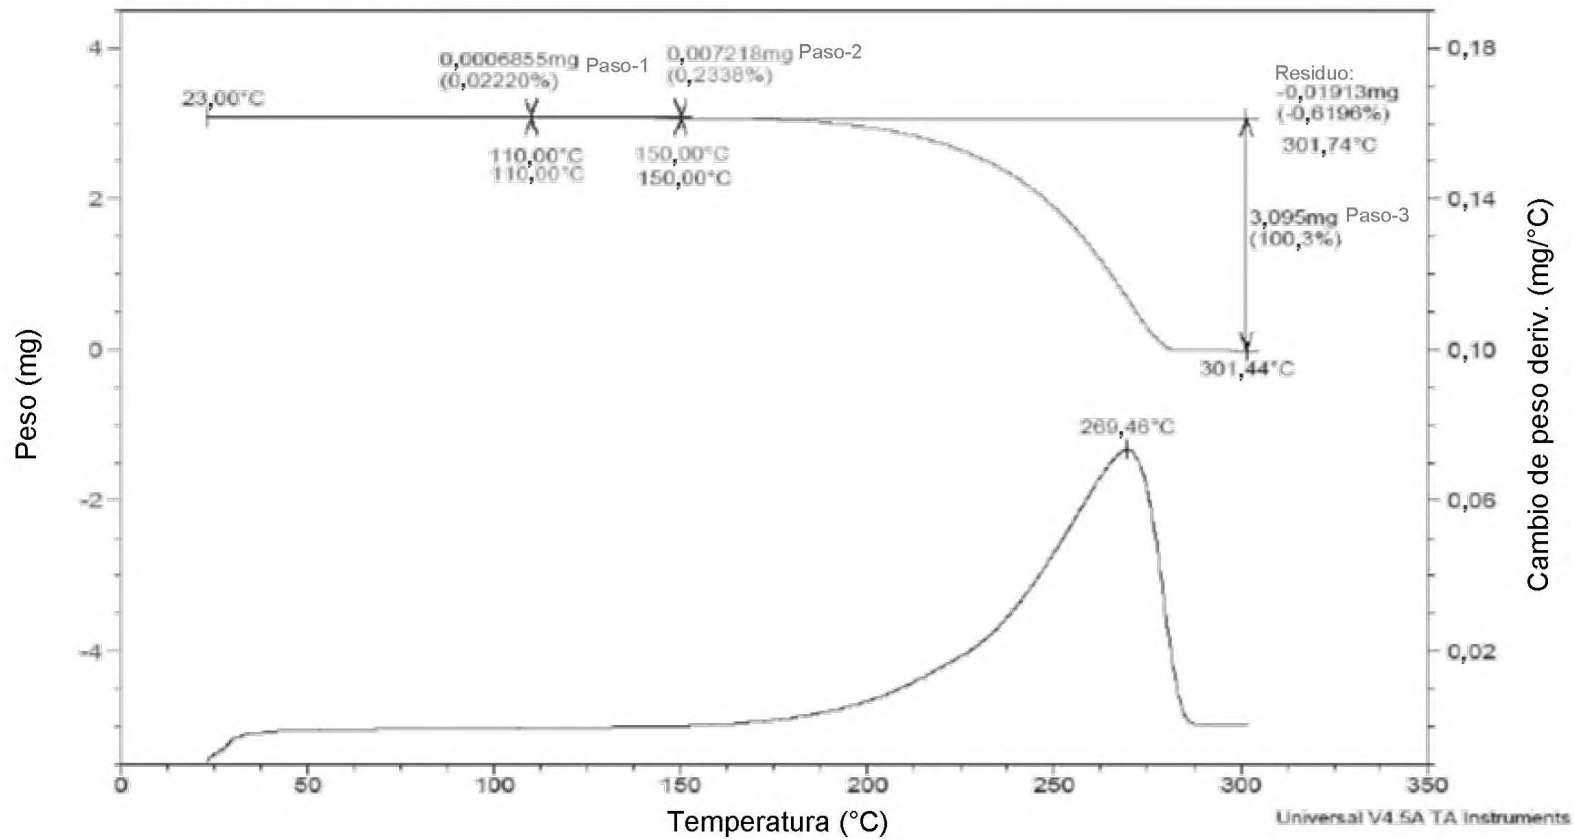


Figura 3